




Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

Dotyczy zaznaczonych parametrów w załączniku nr 1, nr 2, nr 3¹⁾ do zlecenia nr z dn.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 r., poz. 2294
- Decyzji nr
- Inne


Zaznaczyć wybraną zasadę podejmowania decyzji

- Zasada podejmowania decyzji w oparciu o prostą akceptację (ILAC-G8:09/2019 pkt. 4.2.1.)

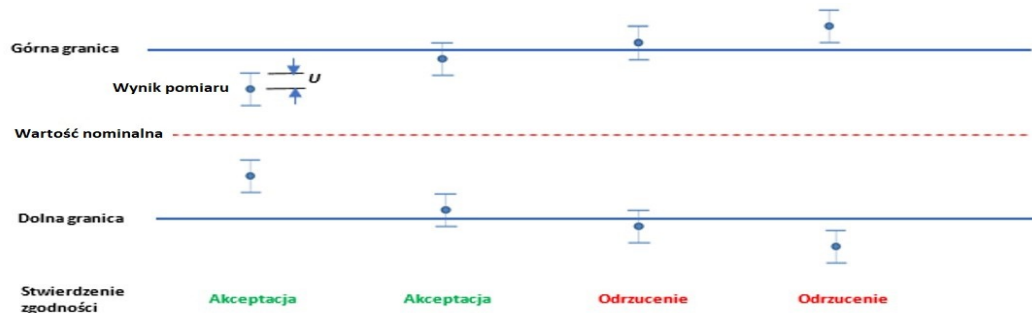

$U = 95\%$ rozszerzona niepewność pomiaru
Ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia wynosi 50%.

- Zasada podejmowania decyzji w oparciu o pasmo ochronne (w) równe niepewności pomiaru (U) (ILAC-G8:09/2019 pkt. 4.2.3.)

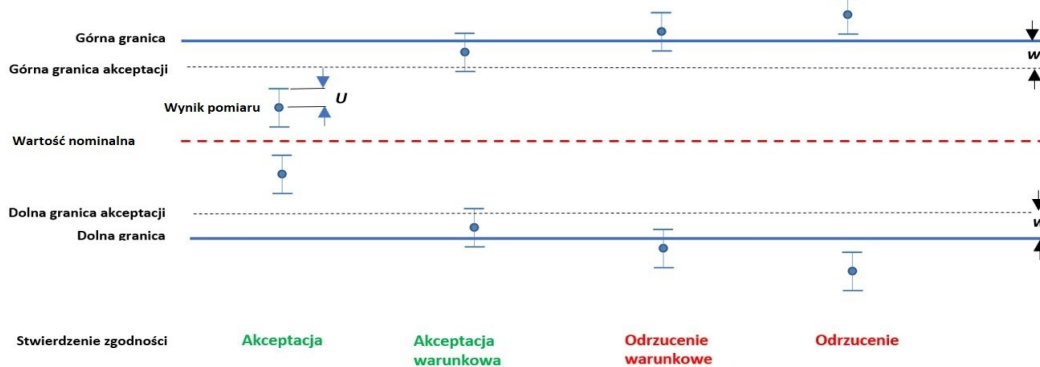

$U = 95\%$ rozszerzona niepewność pomiaru
Dla akceptacji i odrzucenia ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%
Dla warunkowej akceptacji i warunkowego odrzucenia ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia wynosi do 50%

Zostałem poinformowany, że organ decyzyjny może mieć inną zasadę podejmowania decyzji o zgodności lub niezgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Akceptacja klienta

.....
data i podpis

1) - zaznaczyć właściwe